

1. 開啟已完成處理之表單文件或畫面，點選列印功能

列印現行視圖或文件

**檔案(F)** 編輯(E) 檢視(V) 建立(C) 動作(A) 附件檔(T) 工具(O) 說明(H)

- 新增(N) Ctrl+W
- 關閉(C)
- 另存新檔(V)... Ctrl+Shift+S
- 自動儲存(U)
- 應用程式(T)
- 抄寫(R)
- 位置(L)
- 即時訊息(M)
- 匯出(E)...
- 版面設定(G)...
- 預覽列印(W)
- 列印(P)...** Ctrl+P
- 喜好設定(F)
- 內容(E) Alt+Enter
- 安全性(Y)
- 關閉所有已開啟的視窗標籤(L)
- 儲存視窗狀態(V)
- 結束(X)

工作區
材料檢驗結果OA核簽單 - B.依公...
材料檢驗結果OA核簽單

材料檢驗結果OA核簽

若本單"檢驗人員"傳送錯誤，請點選"撤銷傳簽"按鈕並主動聯繫輸入人員，以避免被催辦。



本單編號	F085018035	出表日
檢驗部門	D1X10 長庚大學長庚大學分子	檢驗人員
合格與否	Y	核簽權限
補充說明		
附檔	<p>*必須檢附材料檢驗相關單據（材料檢驗表或檢驗通知單、</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">               HP0031.pdf           </div> <div style="text-align: center;">               HP0032.pdf           </div> </div> <p>附件檔容量:1130635 (bytes)</p>	
閱測試(急用)		
附檔		

1.下方欄點擊二次後顯示材料檢驗明細、及其檢驗項目之檢驗數據或說明  
 2.屬廠商提供本企業檢驗之文件，依規定須保留7年。


序	覆核	請購案號/收料單編	項	材料編號/付	品名規格	單位
---	----	-----------	---	--------	------	----

2. 選擇列印為檔案的印表機名稱：凡 Adobe PDF、Microsoft Print to PDF、Microsoft XPS Document Writer 皆可，請自行選擇電腦內可正常運作者。

列印文件


 印表機  紙張設定

印表機

名稱(N) 

- SHARP MX-M452N PCL6 (from LEE-PC) in session 10
- Adobe PDF (from LEE-PC) in session 10
- HP Color LaserJet 5550 PCL6 (from LEE-PC) in session 10
- Microsoft Print to PDF (from LEE-PC) in session 10
- SHARP MX-M452N PCL6 (from LEE-PC) in session 10
- Microsoft XPS Document Writer (from LEE-PC) in session 10
- Microsoft XPS Document Writer
- Adobe PDF

列印圖文





☐ 依照螢幕上的配置(L) ☐ 列印為草稿(D)

☐ 依個別的圖文框(B) ☐ 調整全部圖形比例


☒ 依選取的圖文框(C) ☒ 彩色預覽(W)

列印範圍

☒ 全部(A) ☐ 本頁(G)


☐ 起始頁(F)  到(T) 

份數

份數(B)  1

☒ 逐份列印(O)

3. 點選確定後跳出存檔畫面：存檔類型（副檔名）選擇 PDF 或 XPS

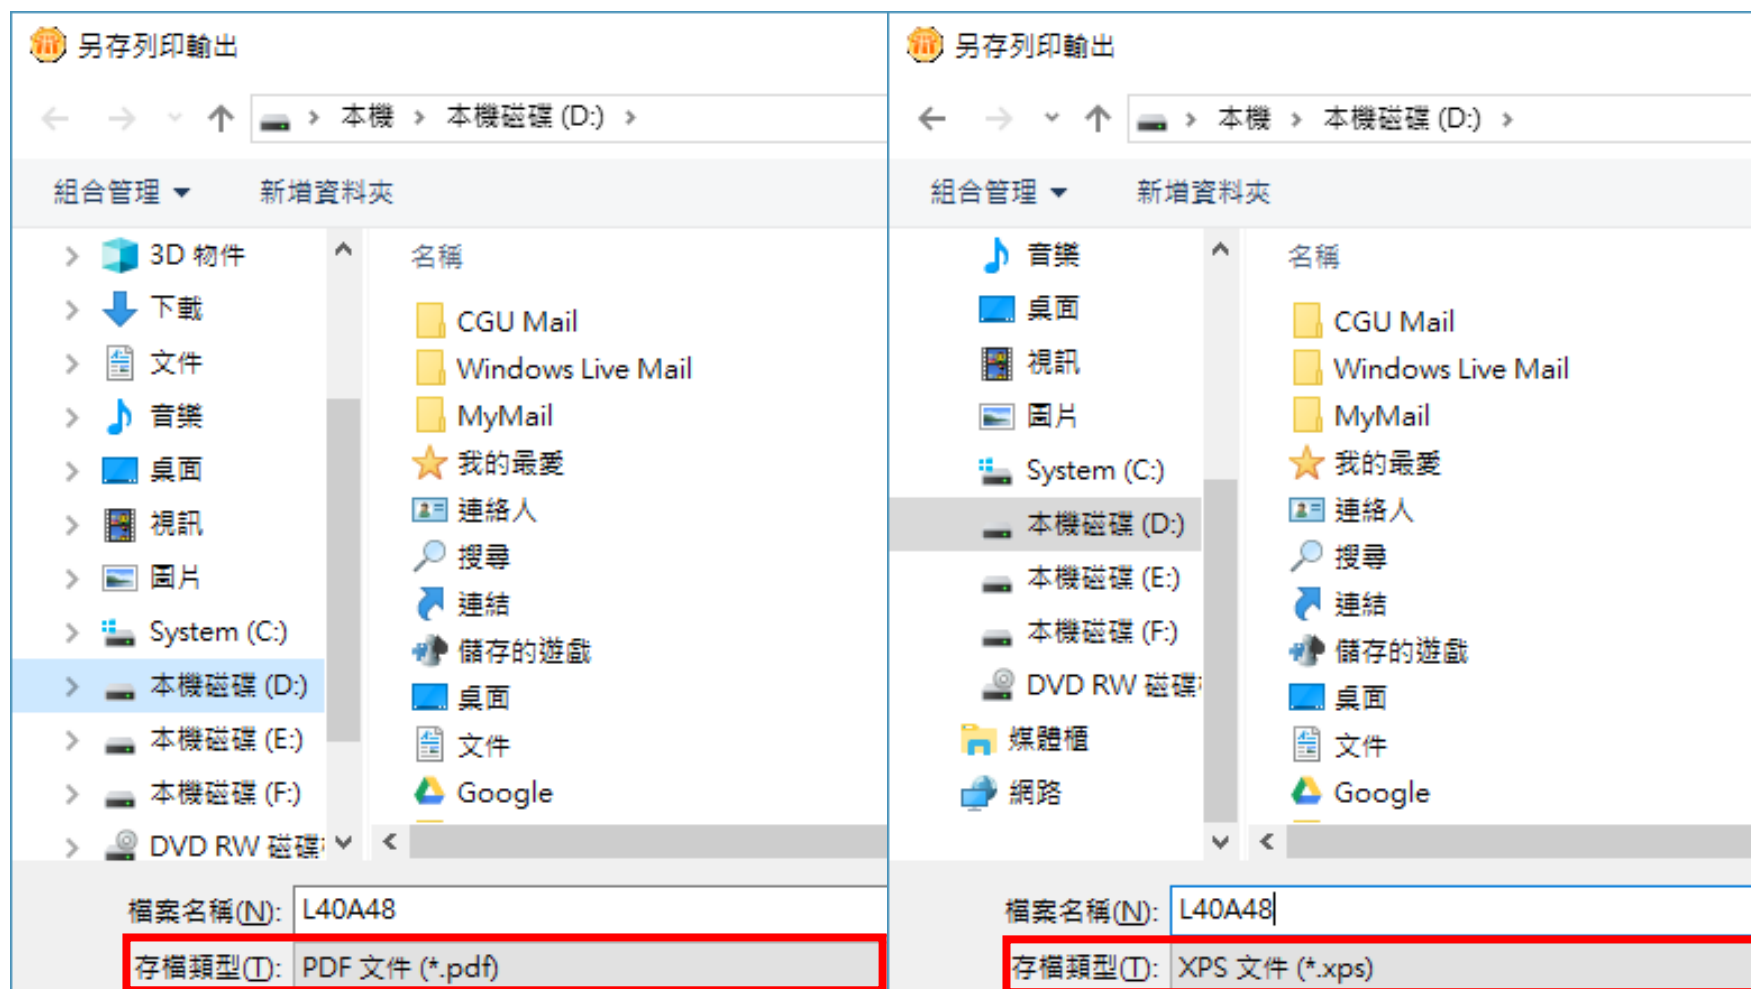

4. 點選確定後即完成存檔